

**REF**

**TGR-R KP 340L**



***INSTRUKCJA OBSŁUGI***

***NÁVOD K OBSLUZE***

***BRUGSANVISNING***

***ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ***

***USER MANUAL***

***KASUTUSJUHEND***

***KORSNIČKE UPUTE***

***NAUDOJIMO INSTRUKCIJA***

***LIETOTĀJA INSTRUKCIJA***

***MANUAL DO UTILIZADOR***

***MANUAL DE INSTRUÇIUNI***

***NÁVOD NA POUŽITIE***

***NAVODILA ZA UPORABO***

***BRUKSANVISNING***

<b>PL INSTRUKCJA OBSŁUGI</b>	3
<b>CS NÁVOD K OBSLUZE</b>	6
<b>DA BRUGSANVISNING</b>	10
<b>EL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</b>	13
<b>EN USER MANUAL</b>	17
<b>ET KASUTUSJUHEND</b>	20
<b>HR KORSNIČKE UPUTE</b>	23
<b>LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA</b>	26
<b>LV LIETOTĀJA INSTRUKCIJA</b>	29
<b>PT MANUAL DO UTILIZADOR</b>	32
<b>RO MANUAL DE INSTRUȚIUNI</b>	36
<b>SK NÁVOD NA POUŽITIE</b>	39
<b>SL NAVODILA ZA UPORABO</b>	42
<b>SV BRUKSANVISNING</b>	45

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Taboret prysznicowy bez oparcia – system TF

Kod produktu: TGR-R KP 340L

#### 1. Wykonanie


Taboret prysznicowy składa się z aluminiowej ramy oraz szerokiego siedziska wykonanego z wytrzymałego PCV. Posiada regulowane na wysokość nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi oraz boczne uchwyty przy siedzisku ułatwiające korzystanie ze sprzętu. Specjalnie zaprojektowane gumowe końcówki nóżek skutecznie zapobiegają ślizganiu się na wilgotnych powierzchniach. Taboret został wyposażony dodatkowo w system TF ułatwiający montaż.

#### Zestaw zawiera:

- siedzisko - 1 szt.
- podstawę taboretu- 2 szt.
- nóżki z regulacją wysokości- 4 szt.
- śruby montażowe (motylki)- 5 szt.

#### Części składowe:

- a. siedzisko
- b. rurki podstawy
- c. regulacja wysokości- sztyft blokujący
- d. nasadki antypoślizgowe

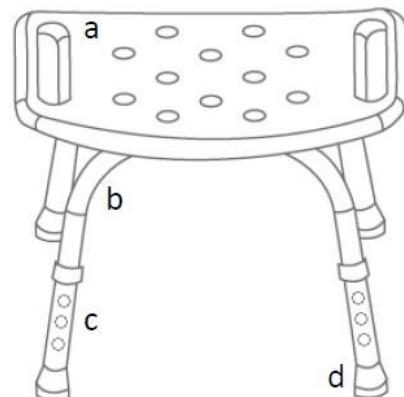

#### 2. Zastosowanie

Taboret prysznicowy jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonywanie czynności higienicznych. Polecaný jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego. Taboret polecaný jest do stosowania

pod prysznicem, w wannie, łazience i innych wilgotnych pomieszczeniach, w warunkach domowych i szpitalnych.

### 3. Montaż

**Krok 1.** Siedzisko taboretu należy położyć płasko na podłożu.

**Krok 2.** Następnie za pomocą pięciu śrub motylkowych z podkładkami należy zmontować siedzisko ze skrzyżowanymi rurkami podstawy taboretu.

**Krok 3.** Rurki podstawy taboretu należy połączyć z nóżkami.



### REGULACJA WYSOKOŚCI

Aby wyregulować wysokość taboretu, należy wcisnąć metalowy sztyft, wybrać odpowiednią wysokość nóżki, a następnie zablokować położenie względem siebie sztyftem blokującym. Nóżki regulowane są skokowo co 2,5 cm. **Uwaga!** Sztyfty we wszystkich nóżkach muszą być ustawione na tym samym poziomie.

### 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość	49 cm
Głębokość	39 cm
Wysokość	36-46 cm
Wymiary siedziska	49 x 29 cm
Waga	2,06 kg
Maksymalne obciążenie	136 kg

### 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z taboretu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja

- Taboret należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- **Należy systematycznie sprawdzać:**
  - dokręcenie śrub motylkowych
  - stan sztyftów blokujących
  - stan rurek (pod kątem pęknięć)

Zaleca się regularną kontrolę nasadki gumowej. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

## 7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 8. Oznaczenia

<b>REF</b>	Numer referencyjny		Producent
<b>LOT</b>	Numer serii		Data produkcji
<b>SN</b>	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
<b>CE</b>	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com). Dziękujemy za wybór Timago!

# NÁVOD K OBSLUZE

## Sprchová stolička bez opěradla - TF systém

Kód produktu: TGR-R KP 340L




### 1. Provedení

Sprchová stolička se skládá z hliníkového rámu a širokého sedátka z odolného PVC. Má výškově nastavitelné nožičky zakončené protiskluzovými prýžovými násadci, úchyty pro sprchovou hlavici a bočními úchyty u sedátka pro snadné používání výrobku. Speciálně navržené prýžové koncovky nožiček účinně zabraňují uklouznutí na mokrému povrchu. Stolička je navíc vybavena systémem TF pro snadnou montáž (montáž bez náradí).

#### Součásti:

- a. sedátko
- b. trubky podstavce
- c. zajišťovací kolík (pro nastavení výšky)
- d. protiskluzový násadec
- e. úchyt pro sprchovou hlavici

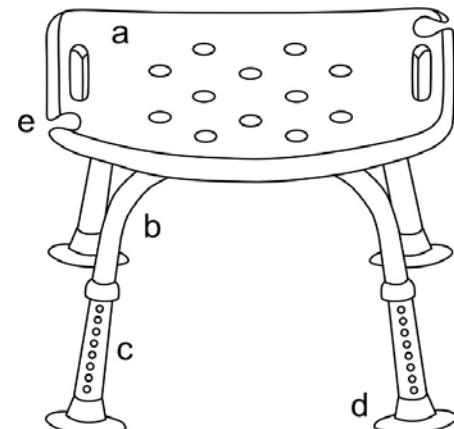

#### Sada obsahuje:

sedátko - 1 kus,  
trubky podstavce stoličky - 2 kusy,  
výškově nastavitelné nožičky - 4 ks,  
montážní šrouby - 5 ks.

### 2. Použití

Sprchová stolička je pomůcka, která uživateli usnadňuje provádění hygienických úkonů. Doporučuje se pro osoby se sníženou mobilitou, která znemožňuje nebo ztěžuje samostatné provádění činností denního života. Stolička se doporučuje pro použití ve sprše, vaně, v koupelnách a jiných vlhkých prostorách v domácnostech a nemocnicích.

### 3. Montáž

**Krok 1.** Položte sedátko stoličky na plocho na zem.

**Krok 2.** Umístěte obě trubky tvořící základnu stoličky v určených bodech na sedátku.

**POZOR!** Ujistěte se, že protínající se základní trubky jsou nasměrovány vroubků k sobě (fotografie níže).

**Krok 3.** Pomocí montážního šroubu upevněte trubky ve středu stoličky.

**Krok 4.** Poté připevněte zbytek montážních šroubů a nezapomeňte přidat podložky.

Aby byl spoj stabilní, měly by profilované kovové podložky obejmout trubky podstavce stoličky.

**Krok 5.** Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně dotaženy.

**POZOR!** Pravidelně kontrolujte utažení šroubů.



### NASTAVENÍ VÝŠKY

- Chcete-li nastavit výšku stoličky, zatlačte zajišťovací kolík, zvolte požadovanou výšku nohou a následně polohu zajistěte pomocí kolíku. Nohy jsou nastavitelné v krocích po 2,5 cm.

**Pozor!** Všechny zajišťovací kolíky musí být nastaveny ve stejné úrovni.

### 4. Technické parametry

Celková šířka	51 cm
Celková hloubka	41 cm
Nastavitelná výška	39-57 cm
Rozměry sedátka	51 x 31 cm
Hmotnost	1,80 kg
Maximální zatížení	136 kg

## **5. Připomínky a doporučení**

**Společnost Timago International Group neodpovídá za nesprávné použití výrobku, nedodržení bezpečnostních pravidel nebo použití k jinému než určenému účelu.**

## **6. Údržba**

- Stoličku je třeba pravidelně čistit vodou, houbou a jemnými čisticími prostředky na plasty např. mýdlem nebo jemnými detergenty. Po každém použití otřete stoličku do sucha.
- K čištění **nepoužívejte**: silné čisticí prostředky, abrazivní prostředky, bělidla, benzín ani žádná rozpouštědla.
- **Pravidelně kontrolujte**: utažení šroubů, stav zajišťovacích kolíků, stav trubek (zda nejsou poškozené)

Doporučuje se pravidelná kontrola pryžových násadců. Pokud je opotřebovaný, vyměňte násadec za nový.

## **7. Podmínky skladování a přepravy**

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vodě ani vlhkosti.

## **8. Záruka**

Na výrobek se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou popsány v záručním listu, který jste obdrželi. Doklad o nákupu (účtenka nebo faktura) musí být uchován pro účely záruky.

## 9. Popis

<b>REF</b>	Referenční číslo		Výrobce
<b>LOT</b>	Číslo šarže		Datum výroby
<b>SN</b>	Sériové číslo		Zdravotnický prostředek
	Pozor		Seznamte se s návodem k použití
<b>CE</b>	Výrobce posoudil shodu se základními požadavky na zdravotnické prostředky.		

Celý sortiment je k dispozici u našich distributorů. Více informací najdete na [www.timago.com](http://www.timago.com). Děkujeme, že jste si vybrali Timago!

# **BRUGSANVISNING**

## **Brusestol u. ryglæn – TF-systemet**

**Produktkode: TGR-R KP 340L**




### **1. Udførelse**

En brusestol består af et aluminiumsstel og et bredt sæde, som er lavet af holdbart PVC. Den har højdejusterbare ben m. anti-skrid fodder, en bruseholder og sidegreb på sædet, der gør det lettere at bruge udstyret. De specialudformede gummifodder giver god skridsikkerhed på våde overflader. Stolen er yderligere udstyret m. TF-systemet, der letter monteringen (værktøjsfri montering).

#### **Stolen består af:**

- a. et sæde
- b. et stelrør
- c. en låsepind (til højdejustering)
- d. en anti-skrid fod
- e. en bruseholder

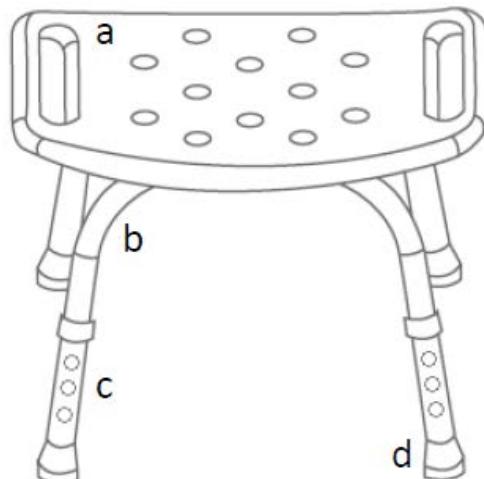

**Sættet indeholder:** et sæde - 1 stk., stelrør - 2 stk., højdejusterbare ben - 4 stk., monteringsskruer - 5 stk.

### **1. Anvendelse**

En brusestol er et hjælpemiddel, der gør det nemmere for brugeren at udføre de daglige hygiejnerutiner. Den anbefales til personer m. nedsat fysisk funktionsevne, der gør det umuligt el. vanskeligt for vedkommende selvstændigt at udføre dagligdags aktiviteter. Stolen er designet til brug i brusebad, i badekar, på badeværelset og i andre vådrum, under hjemlige forhold og på hospitalet.

### **2. Montering**

**Trin 1.** Læg sædet fladt på underlaget.

**Trin 2.** Anbring rørene, der danner stolstellet, på det dertil egnede steder.

**BEMÆRK.** Kontrollér, at de krydsende stelrør vender m. hulrummene i forhold til hinanden (se figuren nedenfor).

**Trin 3.** Fastgør sædet til krydsstellet vha. en monteringsskrue.

**Trin 4.** Fastgør dernæst de øvrige monteringsskruer, husk at sætte spændeskiverne på.

Sørg for, at de profilerede metalspændeskiver sidder tæt på stelrørene for dermed at sikre en stabil forbindelse.

**Trin 5.** Kontrollér, at alle skruerne er spændt korrekt.

**BEMÆRK!** Kontrollér skruerne regelmæssigt for korrekt tilspænding.



## HØJDEJUSTERING

- For at justere stolen i højden, skal du trykke på låsepinden og vælge den ønskede benhøjde, og dernæst låse det i position. Højden på benene justeres trinvist for hver 2,5 cm.

**Bemærk!** Låsepindene i alle benene skal være indstillet til samme højde.

## 3. Teknisk specifikation

Totalbredde	51 cm
Totaldybde	41 cm
Højdejustering	39-57 cm
Sædedimensioner	51 x 31 cm
Vægt	1,80 kg
Maks. belastning	136 kg

## 4. Bemærkninger og anvisninger

Timago International Group frasiger sig ethvert ansvar for uhensigtsmæssig anvendelse af stolen, manglende overholdelse af sikkerhedsreglerne og anvendelse af stolen i strid med formålet.

## 5. Vedligeholdelse

- Stolen skal rengøres regelmæssigt i vand, m. en svamp og ikke-aggressive rensemidler til plast, f.eks. sæbe el. blide vaskemidler. Aftør grundigt efter brug.
- **Undlad at bruge:** aggressive poleringsmidler, stærke rengøringsmidler, slibemidler, blegemidler, benzin el. nogen som helst opløsningsmidler til rengøring.
- **Kontrollér regelmæssigt:** til spændingen af vingeskruerne, tilstanden af låsepindene, tilstanden af rørene (for evt. brud)
- Det anbefales at kontrollere gummifødderne regelmæssigt. Er fodden slidt, skal den udskiftes med en ny.

## 6. Opbevarings- og transportbetingelser

Produktet bør ikke udsættes for direkte sollys, vand og fugt.

## 7. Garantioplysninger

Produktet er omfattet af garantien. Garantivilkårene er beskrevet i garantikortet, som du fik udleveret. Gem købsbeviset (kvittering el. faktura) til garantiformål.

## 8. Mærkning

<b>REF</b>	Referencenummer		Producent
<b>LOT</b>	Partinummer		Produktionsdato
<b>SN</b>	Serienummer		Medicinsk udstyr
	Bemærk		Læs brugsanvisningen nøje igennem
	Producenten har vurderet produktets forenelighed m. de væsentlige krav, der stilles til medicinsk udstyr.		


Hele sortimentet er tilgængeligt hos vores distributører. Find ud af mere på [www.timago.com](http://www.timago.com). Tak, fordi du valgte Timago!

### 1. Κατασκευή

Το κάθισμα μπάνιου αποτελείται από σκελετό αλουμινίου και φαρδιά οριζόντια επιφάνεια από ανθεκτικό PVC. Διαθέτει πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με αντιολισθητικά προστατευτικά από καουτσούκ, υποδοχή για την κεφαλή ντους και πλαϊνές λαβές στη οριζόντια επιφάνεια για διευκόλυνση της χρήσης του προϊόντος. Τα ειδικά σχεδιασμένα ελαστικά προστατευτικά των ποδιών αποτρέπουν αποτελεσματικά την ολίσθηση σε βρεγμένες επιφάνειες. Το κάθισμα είναι εξοπλισμένο με το σύστημα TF για εύκολη συναρμολόγηση (συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία).

### Μέρη:

- a. οριζόντια επιφάνεια
- b. σωλήνες βάσης
- c. πείρος ασφάλισης (ρύθμιση ύψους)
- d. αντιολισθητικό προστατευτικό
- e. υποδοχή για την κεφαλή ντους

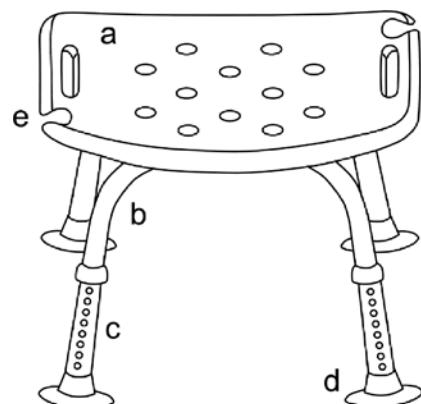

Το σετ περιλαμβάνει: οριζόντια επιφάνεια - 1 τμχ, σωλήνες βάσης καθίσματος - 2 τμχ, πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος 4 τμχ, βίδες στερέωσης - 5 τμχ.

### 2. Χρήση

Το κάθισμα μπάνιου είναι μια βοηθητική συσκευή που βοηθά τον χρήστη να εκτελεί δραστηριότητες υγιεινής. Συνιστάται για άτομα με μειωμένη κινητικότητα που καθιστά αδύνατη ή δύσκολη την ανεξάρτητη εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων. Το κάθισμα συνιστάται για χρήση στο ντους, στη μπανιέρα, μπάνιο και άλλα υγρά δωμάτια, σε συνθήκες σπιτιού και νοσοκομείων.

### 3. Συναρμολόγηση

**Στάδιο 1.** Τοποθετήστε την οριζόντια επιφάνεια του καθίσματος στο έδαφος.

**Στάδιο 2.** Τοποθετήστε τους σωλήνες που σχηματίζουν τη βάση του καθίσματος σε καθορισμένα σημεία στην οριζόντια επιφάνεια.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Βεβαιωθείτε ότι οι τεμνόμενοι σωλήνες βάσης δείχνουν με τις εσοχές τους ο ένας προς τον άλλο (φωτογραφία παρακάτω).

**Στάδιο 3.** Χρησιμοποιώντας τη βίδα στερέωσης, συνδέστε τους σωλήνες βάσης στο κέντρο του καθίσματος.

**Στάδιο 4.** Στη συνέχεια, συνδέστε τις υπόλοιπες βίδες στερέωσης, μην ξεχνάτε να προσθέσετε ροδέλες.

Για να είναι σταθερή η σύνδεση, οι μεταλλικές ροδέλες με προφίλ πρέπει να καλύπτουν τους σωλήνες βάσης του καθίσματος.

**Στάδιο 5.** Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες έχουν σφίξει σωστά. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το σφίξιμο των βιδών πρέπει να ελέγχεται τακτικά.



## ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

- Για να ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος, πατήστε τον μεταλλικό πείρο, επιλέξτε το κατάλληλο ύψος του ποδιού και, στη συνέχεια, κλειδώστε τη θέση μεταξύ τους με τον πείρο ασφάλισης.

Τα πόδια ρυθμίζονται σε βήματα των 2,5 cm.

Προσοχή! Οι πείροι σε όλα τα πόδια πρέπει να τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο.

## 4. Τεχνικές προδιαγραφές

Συνολικό πλάτος	51 cm
Συνολικό βάθος	41 cm
Ρύθμιση ύψους	39-57 cm
Διαστάσεις καθίσματος	51 x 31 cm
Βάρος	1,80 kg
Μέγιστο φορτίο	136 kg

## **5. Επισημάνσεις και συστάσεις**

Ο Όμιλος Timago International δεν ευθύνεται για ακατάλληλη συντήρηση του προϊόντος, μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας ή για χρήση αντίθετη με τον προορισμό του.

## **6. Συντήρηση**

- Το κάθισμα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά με νερό, σφουγγάρι και ήπια καθαριστικά για πλαστικά, π.χ. σαπούνι ή ομαλά απορρυπαντικά. Σκουπίστε στεγνά μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό ισχυρά απορρυπαντικά, λειαντικά, λευκαντικά, βενζίνη ή άλλους διαλύτες.
- Ελέγχετε τακτικά: σφίξιμο των βιδών πεταλούδας, κατάσταση των πείρων ασφάλισης, κατάσταση σωλήνων (για ρωγμές)  
Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τα προστατευτικά από καουτσούκ. Εάν έχει φθαρεί, αντικαταστήστε το προστατευτικό με ένα νέο.

## **7. Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς**

Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, νερό ή υγρασία.

## **8. Στοιχεία εγγύησης**

Το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, οι όροι της οποίας περιγράφονται στην κάρτα εγγύησης που παραλάβατε. Για λόγους εγγύησης, κρατήστε την απόδειξη της αγοράς (απόδειξη ή τιμολόγιο).

## 9. Σημάνσεις

<b>REF</b>	Αριθμός αναφοράς		Κατασκευαστής
<b>LOT</b>	Αριθμός σειράς		Ημερομηνία παραγωγής
<b>SN</b>	Σειριακός αριθμός		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Προσοχή		Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης
<b>CE</b>	Ο κατασκευαστής αξιολόγησε τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.		

Ολόκληρη η γκάμα είναι διαθέσιμη από τους διανομείς μας. Μάθετε περισσότερα στο [www.timago.com](http://www.timago.com). Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Timago!

# USER MANUAL

## Shower chair – tool free

### Product code: TGR-R KP 340L



## 1. Characteristics


Shower chair consists of aluminium frame and wide seat made of durable PVC. The chair is equipped with height adjustable legs with anti-sliding rubber tips and integrated handles which facilitate using the product. Specially designed rubber tips prevent the chair from sliding on wet surfaces. The chair is additionally supplied with Tool-Free (TF) system facilitating the assembly.

## The set includes:

- seat – 1 pc
- chair base – 2 pcs
- height adjustable legs – 4 pcs
- mounting screws (wing screws) – 5 pcs

## Elements of the commode chair:

- a. seat
- b. base tubes
- c. height adjustment – locking pin
- d. anti-sliding tips

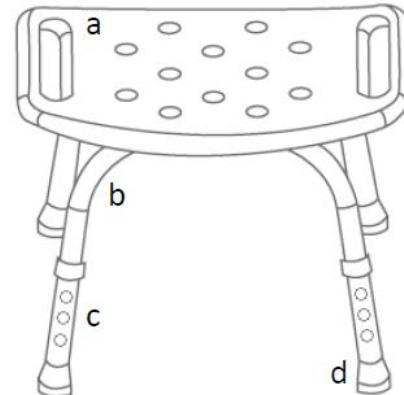

## 2. Application

The shower chair is ancillary equipment which helps the user to perform hygienic activities. The chair is recommended to people with reduced mobility which prevents or hinders the unassisted performance of daily living activities. The chair can be used in the shower, in the bath, in bathrooms and other humid rooms at home and in hospitals.

## 3. Assembly

**Step 1.** Place seat upside down on a flat surface.

**Step 2.** Fix crossed base tubes with seat using five wing screws with washers.

**Step 3.** Join base tubes with legs.

## HEIGHT ADJUSTMENT

- To adjust the height of the shower chair, press metal pin, select appropriate height of leg, and lock the position of the tubes relative to each other with the use of metal pin. The legs are adjustable in 2.5 cm increments.

**Note!** The pins must be set on the same level in each leg.

#### 4. Technical data

Width	49 cm
Depth	39 cm
Height	36-46 cm
Seat dimensions	49 x 29 cm
Weight	1.5 kg
Maximum capacity	136 kg

#### 5. Notes

**6. Timago International Group does not bear responsibility of improper use of the shower chair, failure to comply safety regulations and misuse.**

#### 7. Maintenance

- Clean the shower chair regularly using only water, sponge and mild detergents for plastic materials such as soap. Dry thoroughly.
- **Do not use** for cleaning: strong detergents, abrasive agents, bleach, petrol or solvents (it may cause frame damage, visible defects and in consequence - loss of warranty rights).
- At least once every three months check:
  - tightening of wing screws
  - condition of locking pins
  - condition of tubes (if cracks)
 It is recommended to check the rubber tips regularly. In case of worn-out, replace the tips with the new ones.

#### 8. Storage and transport conditions

Device should not be exposed to direct sunlight, water or moisture.

## 9. Warranty information

All products distributed by our company are covered by a warranty, the terms of which are described in the warranty card available on our website. Please contact the retailer from whom you purchased the product. Please, keep in mind that for warranty purposes, the proof of purchase (receipt or invoice) should be retained

## 10. Labels

<b>REF</b>	Reference number		Manufacturer
<b>LOT</b>	LOT number		Manufacture date
<b>SN</b>	Serial number		Medical device
	Note		Please read the instruction
	The manufacturer checked for compliance with essential medical devices requirements.		

Our complete line of products is available from our distributors.

Learn more at: [www.timago.com](http://www.timago.com). Thank you for choosing Timago!

# KASUTUSJUHEND

## Seljatoeta dušitaburet – TF süsteem

### Tootekood: TGR-R KP 340L




#### 1. Teostus

Dušitaburet koosneb alumiiniumraamist ning vastupidavast PVC-st valmistatud laiast istmest. Sellel on reguleeritava kõrgusega libisemisvastaste kummiotsikutega jalad, dušipihusti hoidikud ja toote kasutamist hõlbustavad, istme juures paiknevad küljekäepidemed. Spetsiaalselt projekteeritud kummiotsikud väldivad tõhusalt märjal pinnal libisemist. Taburet on varustatud kokkupanekut (tööriistavaba) hõlbustava TF-süsteemiga.

#### Koostisosad:

- a. iste
- b. aluse torud
- c. lukustustihvt (kõrguse reguleerimine)
- d. libisemisvastane otsik
- e. dušipihusti hoidikud

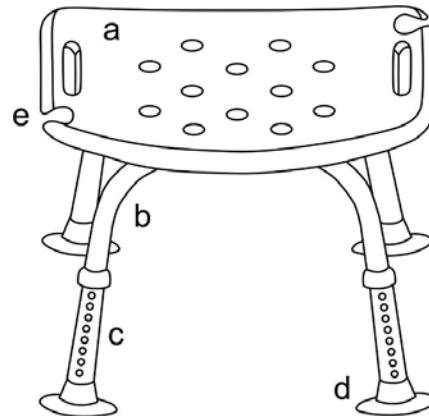

**Komplekti kuuluvad:** iste - 1 tk, tabureti aluse toru - 2 tk, reguleeritava kõrgusega jalad 4 tk, paigalduskruvid - 5 tk.

#### 2. Kasutusotstarve

Dušitaburet on kasutajal hügieenitoimingute teostamist hõlbustav abivahend. Soovitatav inimestele, kellel on piiratud liikumisvõime, mis teeb argitoimingute iseseisva sooritamise võimatuks või raskendab seda. Taburetti soovitatakse kasutada duši all, vannis, vannitubades ja muudes niisketes ruumides, kodustes ning haigla tingimustes.

#### 3. Paigaldamine

- 1. samm** Asetada tabureti iste lamedalt aluspinnale.
- 2. samm** Paigutada istmel märgitud kohtadesse tabureti aluse moodustavad torud.

**TÄHELEPANU!** Veenduda, et aluse ristuvad torud paikneksid süvistega vastastikku (foto allpool).

**3. samm** Kinnitada aluse torud paigalduskruviga tooli keskele.

**4. samm** Seejärel kinnitada ülejäänud paigalduskruid, pidades meeles seibid lisada.

Ühenduse stabiilsuse tagamiseks peavad profileeritud metallseibid tabureti aluse torusid ümbritsema.

**5. samm** Kontrollida, kas kõik kruvid on korralikult kinni keeratud.

**TÄHELEPANU!** Kontrollida regulaarselt kruvide pingutatust.



### KÕRGUSE REGULEERIMINE

- Tabureti kõrguse reguleerimiseks lükata metalltihvt sisse, valida jala soovitud kõrgus ja lukustada seejärel asetus enda suhtes lukustustihvtiga. Jalad on reguleeritavad 2,5 cm sammuga.

**Tähelepanu!** Kõikide jalade tihtid peavad paiknema samal tasemel.

### 4. Tehniline spetsifikatsioon

Üldine laius	51 cm
Kogusügavus	41 cm
Kõrguse reguleerimine	39-57cm
Istme mõõtmed	51 x 31 cm
Kaal	1,80 kg
Maksimaalne kandevõime	136 kg

## 5. Märkused ja soovitused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutuseeskirjade mittejärgimise või mittesihtotstarbelise kasutamise eest.

## 6. Hooldamine

- Taburetti tuleb regulaarselt puhastada, kasutades vett, käsna ja plastidele mõeldud leebeid puhastusvahendeid, nt seepi või delikaatseid pesuvedelikke. Pühkida päraast iga kasutamist kuivaks.
- Puhastamiseks **mitte kasutada**: kangeid puhastusvahendeid, abrasiivseid vahendeid, valgendeid, bensiini või mis tahes lahusteid.
- **Kontrollida süsteemtiliselt**: liblikkruvide pinguldatust, lukustustihvtide seisundit, torude seisundit (pragunemise suhtes)  
Soovitatav on regulaarselt kontrollida kummiotsikuid. Kulumise korral tuleb otsik uue vastu välja vahetada.

## 7. Hoiustamise ja transpordi tingimused

Toodet otsese päikesevalguse, vee või niiskuse toimele mitte allutada.

## 8. Garantiandmed

Toode on hõlmatud garantiiga, mille tingimused on kirjeldatud teile saadetud garantiikaardis. Ostutõend (kviitung või arve) tuleb garantii tarbeks säilitada.

## 9. Märgistused

<b>REF</b>	Viitenumber		Tootja
<b>LOT</b>	Seeria number		Tootmise kuupäev
<b>SN</b>	Seerianumber		Meditsiinitoode
	Tähelepanu		Tutvuge kasutusjuhendiga
<b>CE</b>	Tootja on meditsiinitoodete põhinõuetele vastavuse hinnangu teostanud.		

Kogu valik on teile kättesaadav meie turustajatelt. Lisateavet leiate aadressilt [www.timago.com](http://www.timago.com). Aitäh, et valisite Timago!

# KORSNIČKE UPUTE

## Stolac za tuširanje, bez naslona - sustav TF

Šifra proizvoda: TGR-R KP 340 L




### 1. Izvedba

Stolac za tuširanje sastoji se od aluminijskog okvira i širokog sjedala izrađenog od izdržljivog PVC-a. Ima podesive po visini noge, završene gumenim protukliznim navlakama, držače za tuš slušalicu te bočne rukohvate uz sjedalo koji olakšavaju korištenje proizvoda. Posebno dizajnirani gumeni nastavci nogu učinkovito sprječavaju proklizavanje na vlažnim površinama. Stolac je opremljen sustavom TF koji olakšava montažu (montaža bez alata).

### Sastavni dijelovi

- a. sjedalo
- b. cijevi oslonca
- c. blokadni osigurač/zatik (podešavanje visine)
- d. protuklizna navlaka
- e. držači za tuš slušalicu

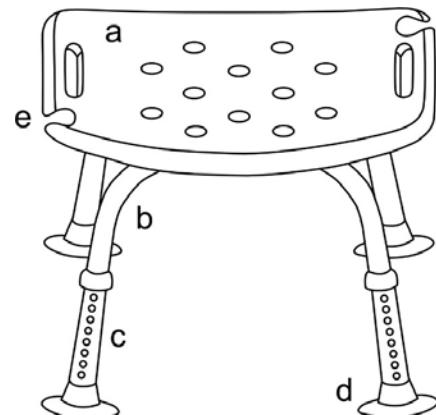

**Set sadrži:** sjedalo – 1 komad, cijevi baze stolca – 2 komada, noge s podešavanjem visine - 4 komada, montažne vijke – 5 komada.

### 2. Primjena

Stolac za tuširanje je pomoćna oprema koja korisniku olakšava obavljanje aktivnosti vezanih uz higijenu. Preporučuje se osobama smanjene pokretljivosti koja onemogućava ili otežava samostalno obavljanje aktivnosti svakodnevnog života. Stolac se preporučuje za primjenu ispod tuša, u kadi, kupatilu i drugim vlažnim prostorijama, u kućnim i bolničkim uvjetima.

### 3. Montaža

**Korak 1.** Sjedalo stolca stavite ravno na pod.

**Korak 2.** Na naznačena mjesta u sjedalu stavite cijevi koje će činiti bazu stolca.

**NAPOMENA!** Uvjerite se da su ukrštene cijevi baze usmjerene udubljenjima jedna prema drugoj (slika dolje).

**Korak 3.** S pomoću montažnog vijka pričvrstite cijevi na sredini stolca.

**Korak 4.** Zatim pričvrstite ostale montažne vijke, ne zaboravite umetnuti podloške.

Kako bi spoj bio stabilan, metalne profilirane podloške trebaju obuhvaćati cijevi baze stolca.

**Korak 5.** Provjerite jesu li svi vijci pravilno pritegnuti.

**NAPOMENA!** Treba redovito provjeravati pritegnutost vijaka.

### **PODEŠAVANJE VISINE**

- Da bi se odabrala visina stolca treba utisnuti metalni osigurač-zatik, izabrati odgovarajuću visinu noge, a zatim blokirati međusobni položaj blokadnim osiguračem. Noge se podešavaju na svakih 2,5 cm.

**Napomena!** Osigurači moraju biti namješteni kod svih nogu u istoj razini

### **4.Tehničke specifikacije**

Ukupna širina	51 cm
Ukupna dubina	41 cm
Podešavanje visine	39-57 cm
Dimenzije sjedala	51 – 31 cm
Težina	1,80 kg
Maksimalno opterećenje	136 kg

### **Opaske i preporuke**

**Timago International Group ne snosi odgovornost za nepravilno korištenje proizvoda, nepridržavanje sigurnosnih pravila i za uporabu suprotnu namjeni.**

### **6. Održavanje**

- Stolac treba redovito čistiti koristeći vodu, spužvu i blaga sredstva za čišćenje za umjetne mase, npr. sapun ili nježne detergente. Nakon svakog korištenja obrinite da bude suh.
- Ne koristite za čišćenje: jake detergente, sredstva za poliranje, izbjeljivače, abrazivna sredstva, benzin niti otapala.
- Treba redovito provjeravati pritegnutost leptirastih vijaka, stanje blokirajućih osigurača, stanje cijevi (u pogledu pukotina),

preporučuje se redovita kontrola gumenih navlaka. U slučaju istrošenosti treba navlaku zamijeniti novom.

## 7. Uvjeti skladištenja i prijevoza

Proizvod ne smije biti izložen izravnom djelovanju sunčevih zraka, vode ili vlage.

## 8. Informacije o jamstvu

Proizvod je pokriven jamstvom čiji su uvjeti opisani u jamstvenom listu koji ste primili. Za potrebe jamstva, čuvajte svoj dokaz o kupnji (račun ili faktura).

## 9. Znakovi

<b>REF</b>	Referentni broj		Proizvođač
<b>LOT</b>	Broj lota		Datum proizvodnje
<b>SN</b>	Serijski broj		Medicinski proizvod
	Pozor		Pročitaj upute
<b>CE</b>	Proizvođač je izvršio ocjenu sukladnosti s bitnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Cjelokupna ponuda dostupna je kod naših distributera. Saznajte više na [www.timago.com](http://www.timago.com). Hvala što ste odabrali Timago!

# NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## Dušo kėdutė be atlošo – TF sistema

### Produkto kodas: TGR-R KP 340L




#### 1. Pagaminimas

Dušo kėdutę sudaro aliuminio rėmas ir sédynė iš patvaraus PVC. Turi reguliuojamo aukščio kojelės su neslystančiais guminiais antgaliais, dušo purkštuvo laikikliais ir šoninėmis rankenomis prie sédynės, kad būtų lengviau naudotis įranga. Specialiai sukurti guminiai kojų antgaliai efektyviai apsaugo nuo slydimo ant šlapių paviršių. Kėdutė turi surinkimą palengvinančią TF sistemą (surinkimas be įrankių).

#### Komponentai:

- a. sédynė
- b. pagrindo vamzdeliai
- c. fiksavimo kaištis (aukščio reg.)
- d. neslystantis antgalis
- e. dušo purkštuvo laikikliai

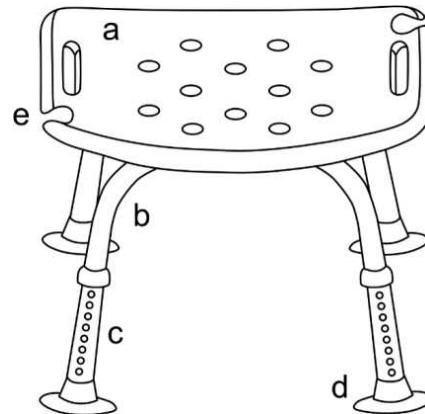

**Komplektą sudaro:** sédynė – 1 vnt., kėdutės pagrindo vamzdeliai – 2 vnt., reguliuojamo aukščio kojelės – 4 vnt., montavimo varžtai – 5 vnt.

#### 2. Panaudojimas

Dušo kėdutė – tai higieninę veiklą vartotojui palengvinanti pagalbinė įranga. Rekomenduojama žmonėms su ribotu judumu, kuris neleidžia arba trukdo savarankiškai atlikti kasdienę veiklą. Kėdutę rekomenduojama naudoti duše, vonioje, vonios kambarysteje ir kitose drėgnose patalpose, namų ir ligoninės sąlygose.

#### 3. Montavimas

**1 žingsnis** Kėdutės sédynė turi būti lygiai ant pagrindo.

**2 žingsnis** Skirtose kėdutės vietose jrenkite abu vamzdelius, sudarančius kėdutės pagrindą.

**DĒMESIO!** Įsitikinkite, kad susikertantys pagrindo vamzdeliai yra nukreipti vienas į kitą (nuotrauka žemiau).

**3 žingsnis** Tvirtinimo varžtu pritvirtinkite pagrindo vamzdelius prie taburetės centro.

**4 žingsnis** Tada įsukite likusius tvirtinimo varžtus, nepamiršdami apie poveržles. Kad sujungimas būtų stabilus, profiliuotos metalinės poveržlės turi uždengti taburetės pagrindo vamzdelius.

**5 žingsnis** Patikrinkite, ar visi varžtai buvo tinkamai priveržti. **DĒMESIO!** Varžtų priveržimas turi būti reguliarai tikrinamas.



#### AUKŠČIO REGULIAVIMAS:

- Norėdami reguliuoti kėdutės aukštį, paspauskite metalinį kaištį, pasirinkite atitinkamą kojos aukštį ir fiksuojamuoju kaiščiu užfiksuokite padėtį vienas kitos atžvilgiu.  
Kojos reguliuojamos kas 2,5 cm.

**Dēmesio!** Visų kojų kaiščiai turi būti tame pačiame lygyje.

#### 4. Techninė specifikacija

Bendras plotis	51 cm
Bendras gylis	41 cm
Aukščio reguliavimas	39 - 57 cm
Sėdynės matmenys	51 x 31 cm
Svoris	1,80 kg
Maksimali apkrova	136

## **5. Pastabos ir rekomendacijos**

**„Timago International Group“ neatsako už netinkamą gaminio naudojimą, saugos taisyklių nesilaikymą ir naudojimą ne pagal paskirtį.**

## **6. Techninė priežiūra**

- Kėdutė turi būti reguliarai valoma vandeniu, kempinėle ir švelniomis plastiko valymo priemonėmis, pvz., muilu ar švelniu plovikliu. Po kiekvieno naudojimo sausai nušluostykite.
- Valymui **nenaudokite**: stiprių ploviklių, abrazyvų, baliklių, benzino ar kitų tirpiklių.
- **Reguliariai tikrinkite**: sparnuotujų varžtų priveržimą, fiksavimo kaiščių būklę, vamzdžių būklę (jtrūkimų atžvilgiu)  
Rekomenduojama reguliarai tikrinti guminius antgalius. Susidėvėjus, pakeiskite antgalį nauju.

## **7. Laikymo ir transportavimo sąlygos:**

Gaminys neturi būti veikiamas tiesioginių saulės spinduliu, vandens ar drėgmės.

## **8. Duomenys apie garantiją**

Gaminui taikoma garantija, kurios sąlygos aprašytoje Jūsų gautame garantiniame talone. Pirkimo įrodymas (kvitas ar sąskaita faktūra) turi būti saugomi garantijos tikslais.

## **9. Žymėjimai**

<b>REF</b>	Referencinis numeris		Gamintojas
<b>LOT</b>	Serijos numeris		Gamybos data
<b>SN</b>	Serijinis numeris		Medicinos gaminys
	Dėmesio		Perskaitykite instrukciją
<b>CE</b>	Gamintojas įvertino gaminio atitiktį pagrindiniams medicinos gaminiams taikomiems reikalavimams.		

Visą assortimentą galite įsigyti iš mūsų platintojų. Sužinokite daugiau [www.timago.com](http://www.timago.com). Dėkojame, kad pasirinkote "Timago"!

# LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

## Dušas krēsls bez atzveltnes – TF sistēma

Produkta kods: TGR-R KP 340L




### 1. Uzbūve

Dušas krēsls sastāv no alumīnija rāmja un plata sēdekļa, kas izgatavots no izturīga PVC. Tam ir regulējamas kājas ar pretslīdes gumijas uzlikas, dušas klausules turētāji un sānu rokturi pie sēdekļa, kas atvieglo izstrādājuma lietošanu. Īpaši izstrādātas kāju gumijas uzlikas novērš slīdēšanu uz slapjas virsmas. Krēsls ir aprīkots ar TF sistēmu, kura atvieglo montāžu (montāža bez instrumentiem).

#### Sastāvdaļas:

- a. sēdeklis
- b. pamatnes caurules
- c. fiksējošā tapa (regulējams augstums)
- d. pretslīdes uzlika
- e. dušas klausules turētāji

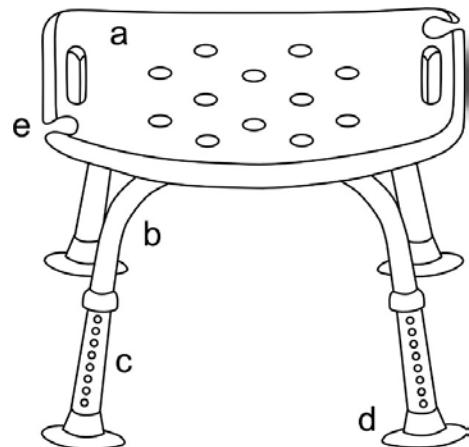

**Komplektā ietilpst:** sēdeklis – 1 gab., krēsla pamatnes caurules – 2 gab., kājas ar regulējamu augstumu – 4 gab., montāžas skrūves – 5 gab.

### 2. Lietošana

Dušas krēsls ir palīgierīce, kas palīdz lietotājam apmierināt higiēniskās vajadzības. Ieteicams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kuri nelauj vai apgrūtina patstāvīgu ikdienas darbību veikšanu. Krēslu ieteicams lietot dušā, vannā, vannas istabā un citās mitrās telpās, mājās un slimnīcās.

### 3. Montāža

- 1. solis.** Novietojiet krēsla sēdekli plakaniski uz zemes.
- 2. solis.** Novietojiet caurules, kas veido krēsla pamatni, atzīmētajās vietās uz sēdekļa.

**UZMANĪBU!** Pārliecinieties, ka krustojošos pamatnes cauruļu padziļinājumi ir vērsti viens pret otru (skat. attēlu zemāk).

**3. solis.** Izmantojot montāžas skrūvi, piestipriniet pamatnes caurules pie krēsla centra.

**4. solis.** Pēc tam uzstādīet pārējās montāžas skrūves, neaizmirstot uzlikt paplāksnes.

Lai savienojums būtu stabils, profilētām metāla paplāksnēm ir jāapskauj krēsla pamatnes caurules.

**5. solis.** Pārbaudiet, vai visas skrūves ir pareizi pievilktais.

**UZMANĪBU!** Regulāri pārbaudiet skrūvju pievilkšanu.



## AUGSTUMA REGULĒŠANA

- Lai noregulētu krēsla augstumu, nospiediet metāla tapu, izvēlieties atbilstošo kājas augstumu un pēc tamnofiksējiet pozīciju ar fiksējošo tapu.

Kājas regulēšanas solis ir 2,5 cm.

**Uzmanību!** Visu kāju tapām ir jābūt vienā līmenī.

## 4. Tehniskā specifikācija

Kopējais platums	51 cm
Kopējais dziļums	41 cm
Augstuma regulēšana	39-57 cm
Sēdekļa izmēri	51 x 31 cm
Svars	1,80 kg
Maksimālā slodze	136 kg

## 5. Piezīmes un ieteikumi

*Timago International Group neuzņemas atbildību par izstrādājuma nepareizu lietošanu, drošības noteikumu neievērošanu vai izmantošanu pretēji paredzētajam mērķim.*

## 6. Apkope

- Krēsls jātīra regulāri, izmantojot ūdeni, sūkli un vieglus tīrišanas līdzekļus plastmasai, piemēram, ziepes vai maigus mazgāšanas līdzekļus. Pēc katras lietošanas reizes noslaukiet sausu.
- Mazgāšanai **nedrīkst izmantot** spēcīgus mazgāšanas līdzekļus, abrazīvos līdzekļus, balinātājus, benzīnu vai jebkādus šķidinātājus.
- **Regulāri pārbaudiet** spārnskrūvju pievilkšanu, bloķēšanas tapu stāvokli, cauruļu stāvokli (vai nav plaisu) Ieteicams regulāri pārbaudīt gumijas uzlikas. Ja uzlika ir nodilusi, nomainiet to pret jaunu.

## 7. Glabāšanas un transportēšanas noteikumi

Produktu nedrīkst pakļaut saules staru, ūdens vai mitruma tiešai iedarbībai.

## 8. Informācija par garantiju

Produktam ir garantija, kuras noteikumi ir atrodami saņemtajā garantijas talonā. Garantijas sūdzību nolūkos saglabājiet pirkumu apliecinošu dokumentu (pirkuma čeku vai rēķinu).

## 9. Apzīmējumi

<b>REF</b>	Atsauces numurs		Ražotājs
<b>LOT</b>	Sērijas numurs		Ražošanas datums
<b>SN</b>	Sērijas numurs		Medicīniskā ierīce
	Piezīme		Izlasiet lietošanas instrukciju!
<b>CE</b>	Ražotājs novērtēja atbilstību medicīnisko ierīču būtiskajām prasībām.		

Viss klāsts ir pieejams pie mūsu izplatītājiem. Uzziniet vairāk [www.timago.com](http://www.timago.com).  
Paldies, ka izvēlējāties Timago!

# **MANUAL DO UTILIZADOR**

## **Banco de chuveiro sem encosto – sistema TF**

**Código do produto: TGR-R KP 340L**




### **1. Execução**

O banco do chuveiro é composto por uma estrutura de alumínio e um assento largo feito de PVC durável. Possui pés reguláveis em altura acabados com tampas de borracha antiderrapante, suportes para a cabeça do chuveiro e alças laterais no assento para fácil utilização do produto. As extremidades dos pés de borracha especialmente concebidas evitam eficazmente o escorregamento em superfícies húmidas. O banco está equipado com um sistema TF para fácil montagem (sem utilização de ferramentas).

### **Componentes:**

- a. assento
- b. tubos de base
- c. pino de bloqueio (ajuste de altura)
- d. tampa antiderrapante
- e. suportes para a cabeça do chuveiro

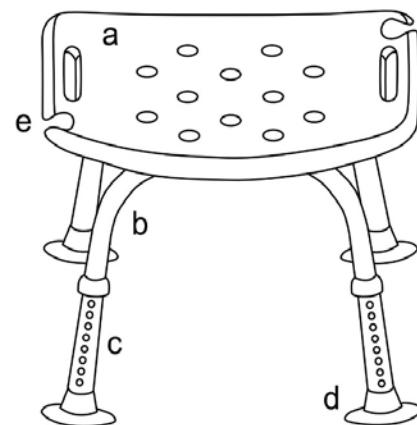

**O conjunto inclui:** assento - 1 un., tubos de base do banco - 2 un., pés ajustáveis em altura - 4 un., parafusos de montagem - 5 un.

### **2. Uso**

O banco de chuveiro é um equipamento auxiliar que facilita as atividades higiénicas do utilizador. É recomendado para pessoas com mobilidade reduzida que impede ou dificulta o desempenho independente das atividades cotidianas. O banco é recomendado para uso no chuveiro, banheira, banho e outras salas húmidas, em casa e em hospitais.

### **3. Montagem**

**Etapa 1.** Coloque o banco no chão.

**Etapa 2.** Coloque os tubos que formam a base do banco nos pontos designados no assento.

**ATENÇÃO!** Certifique-se de que os tubos da base que se cruzam estejam voltados um para o outro através dos recessos (imagem abaixo).

**Etapa 3.** Fixe os tubos de base no meio do banco usando o parafuso de montagem.

**Etapa 4.** Em seguida, fixe o resto dos parafusos de montagem, sem esquecer as arruelas.

Para que a conexão seja estável, as arruelas metálicas perfiladas devem cingir os tubos da base do banco.

**Etapa 5.** Verifique se todos os parafusos estão devidamente apertados.

**ATENÇÃO!** Verifique o aperto dos parafusos regularmente.



## AJUSTE DE ALTURA

- Para ajustar a altura do banco, pressione o pino de metal, selecione a altura adequada do pé e, em seguida, bloquee a posição um em relação ao outro com o pino.

Os pés são ajustáveis em degraus de 2,5 cm.

**Atenção!** Os pinos em todos os pés devem ser ajustados no mesmo nível.

#### **4. Especificações técnicas**

Largura total	51 cm
Profundidade total	41 cm
Ajuste de altura	39-57cm
Dimensões do assento	51 x 31 cm
Peso	1,80 kg
Carga máxima	136 kg

#### **5. Observações e recomendações**

**O Timago International Group não se responsabiliza pelo uso indevido do produto, não cumprimento das regras de segurança e uso indevido.**

#### **6. Manutenção**

- O banco devem ser limpo regularmente com água, esponja e produtos de limpeza de plástico suaves, por exemplo, sabão ou detergente delicado. Seque após cada utilização.
- Para a limpeza **não use**: detergentes fortes, abrasivos, lixívia, gasolina ou quaisquer solventes para limpeza.
- **Verifique regularmente**: aperto dos parafusos de asa, estado dos pinos de bloqueio, estado dos tubos (rachaduras). Recomenda-se a inspeção regular das tampas de borracha. Em caso de desgaste, substitua a tampa por uma nova.

#### **7. Condições de armazenamento e transporte**

Não exponha o produto à luz solar direta, água ou humidade.

#### **8. Detalhes da garantia**

O produto está coberto por uma garantia, cujos termos estão descritos no cartão de garantia que recebeu. Para fins de garantia, o comprovante de compra (recibo ou fatura) deve ser retido.

## 9. Designações

<b>REF</b>	Número de referência		Produtor
<b>LOT</b>	Número de lote		Data de fabrico
<b>SN</b>	Número de série		Dispositivo médico
	Nota		Consulte as instruções
<b>CE</b>	O fabricante avaliou a conformidade com os requisitos essenciais para dispositivos médicos.		

Toda a gama está disponível nos nossos distribuidores. Saiba mais em [www.timago.com](http://www.timago.com). Obrigado por ter escolhido Timago!

# **MANUAL DE INSTRUCȚIUNI**

## **Scaun de duș fără spătar - sistem TF**

### **Cod produs TGR-R KP 340L**




#### **1. Realizare**

Scaunul de duș este format dintr-un cadru din aluminiu și un scaun lat din PVC durabil. Are picioare reglabile pe înălțime finisate cu capace de cauciuc anti-alunecare, mâneră pentru capul de duș și mâneră laterale la scaun pentru o utilizare ușoară a produsului. Terminațiile picioarelor din cauciuc special concepute previn în mod eficient alunecarea pe suprafetele umede. Scaunul este echipat cu sistemul TF pentru o asamblare ușoară (asamblare fără scule).

#### **Componențe:**

- a. scaun
- b. tuburi bază
- c. pin de blocare (reglare înălțime)
- d. capac antiderapant
- e. suporturi pentru capul de duș

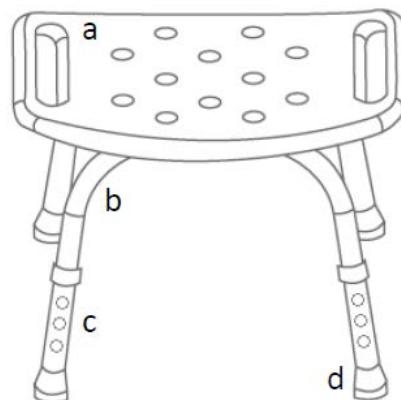

**Setul include:** scaun - 1 bucătă, tuburi pentru baza scaunului - 2 bucăți, picioare reglabile pe înălțime - 4 bucăți, suruburi de asamblare - 5 bucăți.

#### **2. Aplicații**

Scaunul de duș este un echipament auxiliar care facilitează activitățile de igienă ale utilizatorului. Este recomandat persoanelor cu mobilitate redusă, care împiedică sau împiedică desfășurarea independentă a activităților de zi cu zi. Scaunul este recomandat pentru utilizare la duș, în cadă,

#### **3. Montare:**

**Pasul 1.** Așezați șezutul scaunului plat pe sol.

**Pasul 2.** Așezați tuburile care formează baza scaunului în zonele desemnate de pe scaun.

**ATENȚIE! Asigurați-vă că tuburile de bază încrucișate sunt orientate unul spre celălalt (fotografia de mai jos).**

**Pasul 3.** Folosiți șuruburile de montare pentru a fixa tuburile de bază în centrul scaunului.

**Pasul 4.** Apoi fixați restul șuruburilor de montare, asigurându-vă că adăugați șaibe. Pentru a face conexiunea stabilă, șaibele metalice profilate trebuie să cuprindă tuburile de bază ale scaunului.

**Pasul 5.** Verificați dacă toate șuruburile au fost strânse corect.

**ATENȚIE!** Verificați periodic strângerea șuruburilor.



#### REGLAREA ÎNĂLTIMII

- Pentru a regla înăltimea scaunului, apăsați știftul metalic, selectați înăltimea corespunzătoare a piciorului și apoi blocați poziția unui față de celălalt cu știftul de blocare.

Picioarele sunt reglabile în trepte de 2,5 cm.

**ATENȚIE!** Pinurile din toate picioarele trebuie să fie aliniate la același nivel.

#### 4. Specificații tehnice

Lățimea totală	49 cm
Adâncimea totală	39 cm
Reglarea înăltimii	36-46 cm
Dimensiunile scaunului	49 x 29 cm
Greutate	1.5 kg
Sarcină maximă	136kg

#### 5. Observații și note

Grupul Timago International nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului, nerespectarea normelor de siguranță și utilizarea necorespunzătoare.

## 6. Întreținere

- Curățați scaunul în mod regulat folosind apă, un burete și detergenți ușori din plastic, cum ar fi săpun sau detergenți ușori. Stergeți-l după fiecare utilizare.
- A nu se utiliza pentru curățare: detergenți puternici, abrazivi, înlăbitori, benzină sau alți solvenți.
- Verificați sistematic: strângerea șuruburilor fluture, starea șifturilor de blocare, starea tuburilor (pentru fisuri)
- Se recomandă inspecția regulată a capacului de cauciuc. Dacă este uzat, înlocuiți capacul cu unul nou.

## 7. Condiții de depozitare și transport

Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, apă și umiditate.

## 8. Detalii privind garanția

Produsul este acoperit de o garanție, ale cărei condiții sunt descrise în certificatul de garanție pe care l-ați primit. În scopuri de garanție, trebuie păstrată dovada achiziției (chitanță sau factură).

## 9. Marcaje

<b>REF</b>	Număr de referință		Producător
<b>LOT</b>	Număr lot		Data fabricării
<b>SN</b>	Număr serie		Dispozitiv medical
	Atenție!		Citiți instrucțiunile
	Producătorul a evaluat conformitatea cu cerințele esențiale pentru dispozitivele medicale.		

Întreaga gamă vă este disponibilă la distribuitorii noștri. Aflați mai multe la [www.timago.com](http://www.timago.com). Vă mulțumim că ați ales Timago!

# NÁVOD NA POUŽITIE

## Sprchovací stolček bez operadla – systém TF

Kód výrobku: TGR-R KP 340L




### 1. Zhotovenie

Sprchovací stolček tvorí hliníkový rám a široké sedadlo zhotovené z pevného PVC. Má nožičky s nastaviteľnou výškou, ktoré sú zakončené protišmykovými gumenými nadstavcami, ako aj bočné rúčky pri sedadle, ktoré uľahčujú používanie pomôcky. Špeciálne navrhnuté gumené koncovky nožičiek účinne predchádzajú šmýkaniu na vlhkých povrchoch. Stolček má dodatočne systém TF, ktorý uľahčuje montáž.

### Diely:

- a. sedadlo
- b. rúrky podstavca
- c. nastavenie výšky – blokovací kolík
- d. protišmykové nadstavce

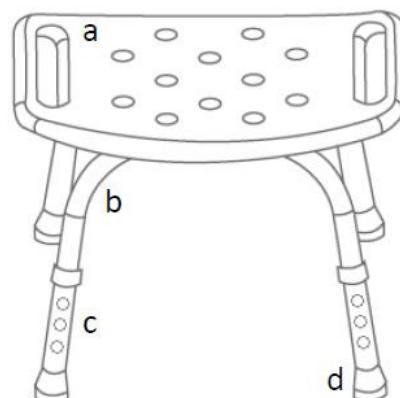

### Obsah súpravy:

- sedadlo – 1 ks
- podstavec stolčeka – 2 ks
- nožičky s nastaviteľnou výškou – 4 ks
- montážne skrutky (krídla) – 5 ks

### 2. Použitie

Sprchovací stolček je pomôcka, ktorá používateľom uľahčuje vykonávanie hygienických činností. Odporúčaný pre osoby so zníženými pohybovými schopnosťami, ktoré neumožňujú alebo stážujú samostatná vykonávanie každodenných činností. Stolček je určený na použitie v sprche, vane, kúpeľni a v iných vlhkých miestnostiach, tak v domácnosti ako aj v zdravotníckych zariadeniach.

### **3. Montáž**

- 1. krok** Sedadlo stolčeka položte plocho na podklade.
- 2. krok** Potom namontujte sedadlo s prekríženými rúrkami k podstavcu stolčeka, použite päť krídlových skrutiek a podložky.
- 3. krok** Rúrky podstavca stolčeka spojte s nožičkami.



### **NASTAVENIE VÝŠKY**

- Ked' chcete nastaviť výšku stolčeka, vytiahnite blokovací kolík, vyberte požadovanú výšku nožičky, a následne blokovacím kolíkom zablokujte vzájomnú polohu. Nožičky sa nastavujú v krokoch po 2,5 cm.
- Pozor!** Blokovacie kolíky vo všetkých nožičkách musia byť nastavené na rovnakej úrovni.

### **4. Technická špecifikácia**

Šírka	49 cm
Hĺbka	39 cm
Výška	36 – 46 cm
Rozmery sedadla	49 x 29 cm
Hmotnosť	2,06 kg
Maximálne zaťaženie	136 kg

### **5. Poznámky a odporúčania**

**Timago International Group nezodpovedá za nesprávne používanie stolčeka, nedodržiavanie bezpečnostných zásad a pokynov, ani za používanie v rozpore s určením.**

## 6. Údržba

- Stolček pravidelne čistite, použite vodu, špongiu a jemný čistiaci prostriedok na umývanie plastov, napr. mydlo alebo jemné detergent, ktoré majú príslušný atest hygienického ústavu, a po každom použití poutierajte dosucha.
- **Nepoužívajte** na čistenie silné čistiace prostriedky, drsné prostriedky, bielidlá, benzín ani žiadne rozpúšťadlá (v opačnom prípade sa môže poškodiť rám, môžu sa objaviť viditeľné kazy, a následne – prestáva platiť poskytnutá záruka).
- **Pravidelne kontrolujte:**
  - dotiahnutie krídlových skrutiek
  - stav blokovacích kolíkov
  - stav rúrok (ohľadne prasknutí)
- Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali gumené nadstavce. Ked' sú opotrebované, vymeňte ich na nové.

## 7. Údaje ohľadne záruky

Všetky výrobky, ktoré distribuuje naša spoločnosť, majú udelenú záruku. Záručné podmienky sú opísané v záručnom liste, ktorý ste dostali pri nákupe výrobku. Súčasne pripomíname, že v prípade zámeru využiť záručné práva musíte predstaviť nákupný doklad (pokladničný blok alebo faktúru).

## 8. Označenia

<b>REF</b>	Referenčné číslo		Výrobca
<b>LOT</b>	Číslo série		Dátum výroby
<b>SN</b>	Sériové číslo		Zdravotnícky výrobok
	Pozor		Oboznámte sa s príručkou a dokumentáciou
<b>CE</b>		Výrobca vykonal hodnotenie zhody s podstatnými požiadavkami na zdravotnícke výrobky.	

Kompletná ponuka je dostupná u našich distribútoroch. Dozvedeťte sa viac na [www.timago.com](http://www.timago.com). Ďakujeme, že ste si vybrali Timago!

# NAVODILA ZA UPORABO

## Sedež za tuš brez naslona – sistem TF

### Koda izdelka: TGR-R KP 340L




#### 1. Izdelava

Sedež za tuš je sestavljen iz aluminijastega okvirja in širokega sedeža iz vzdržljivega PVC. Ima po višini nastavljive noge z nedrsečimi gumijastimi pokrovi, držala za tuš in stranske ročke na sedežu, ki olajšajo uporabo izdelka. Posebej oblikovani gumijasti konci nog učinkovito preprečujejo zdrs na mokrih površinah. Sedež je opremljen s sistemom TF za enostavno montažo (montaža brez orodja).

#### Komponenti:

- a. sedež
- b. cevi osnove sedeža
- c. zaklepni zatič (nastavitev višine)
- d. protizdrsni pokrovček
- e. držala za slušalko

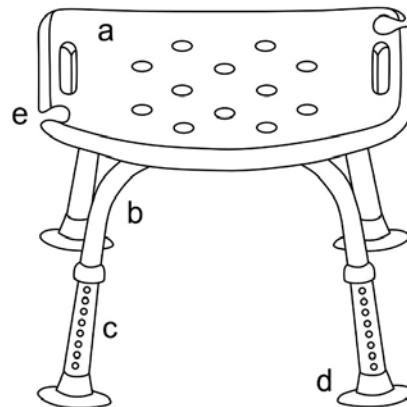

**Komplet vsebuje:** sedež - 1 kos, cevi za osnovo sedeža - 2 kosa, po višini nastavljive noge - 4 kosi, vijaki za montažo - 5 kosov.

#### 2. Uporaba

Sedež za tuš je pomožni pripomoček, ki uporabniku pomaga pri izvajanju higienskih aktivnosti. Priporočljivo je za gibalno ovirane osebe, ki onemogočajo ali otežujejo samostojno opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Sedež je priporočljiv za uporabo v tuš kabini, kadi, kopalnici in drugih vlažnih prostorih, doma in v bolnišnici.

#### 3. Montaža

**Korak 1.** Sedež postavite ravno na tla.

**Korak 2.** Postavite cevi, ki tvorijo osnovo sedeža, na določena mesta na sedežu.

**POZOR!** Prepričajte se, da sta se križajoči se cevi za osnovo obrnjeni z vdolbinami druga proti drugi (spodnja fotografija).

**Korak 3.** S pritrdilnim vijakom pritrdite cevi osnove na sredino sedeža.

**Korak 4.** Nato namestite preostale pritrdilne vijke in ne pozabite dodati podložk. Za stabilno povezavo morajo profilirane kovinske podložke pokrivati osnovne cevi sedeža.

**Korak 5.** Preverite, ali so vsi vijaki pravilno zategnjeni. **OPOMBA!** Redno preverjajte zategnjenoost vijakov.



## NASTAVITEV VIŠINE

- Za nastavitev višine sedeža pritisnite na kovinski zatič, izberite ustrezeno višino noge in nato zaklenite položaj med seboj z zaklepniem zatičem.  
Noge so nastavljive na vsakih 2,5 cm.

**Pozor!** Zaklepni zatiči na obeh nogah morajo biti nastavljeni na isti ravni.

## 4. Tehnična specifikacija

Celotna širina	51 cm
Celotna globina	41 cm
Nastavitev višine	39-57 cm
Dimenzijsedeža	51 x 31 cm
Teža	1,80 kg
Maksimalna obremenitev	136 kg

## 5. Priporočila

**Timago International Group ne odgovarja za nepravilno uporabo hodulje, neupoštevanje varnostnih predpisov in nemamensko uporabo.**

## 6. Vzdrževanje

- Sedež je treba redno čistiti z vodo, gobico in blagimi čistilnimi sredstvi za plastiko na primer z milom ali blagimi detergenti. Po vsaki uporabi obrišite.
- Za čiščenje **ne uporablajte**: močnih detergentov, abrazivnih sredstev, belil, bencina ali kakršnih koli topil.
- **Redno je treba preverjati**: zategnjenos krilnih vijakov, stanje zaklepnih zatičev in stanje cevi (v smislu razpok). Priporočljivo je redno preverjanje gumijastega pokrovčka. Če je obrabljen, zamenjajte pokrovček z novim

## 7. Pogoji skladiščenja in transporta

Izdelek ne sme biti izpostavljen neposredni sončni svetlobi, vodi ali vlagi.

## 8. Garancijski pogoji

Za izdelek velja garancija, katere pogoji so opisani v garancijskem listu, ki ste ga prejeli ob nakupu. Za namene garancije morate hraniči dokazilo o nakupu (paragon ali račun).

## 9. Oznake

<b>REF</b>	Referenčna številka		Proizvajalec
<b>LOT</b>	LOT številka		Datum proizvodnje
<b>SN</b>	Serijska številka		Medicinski pripomoček
	Pozor		Preverite navodila
<b>CE</b>	Proizvajalec je ocenil skladnost z bistvenimi zahtevami za medicinske pripomočke.		

Celotna ponudba je na voljo pri naših distributerjih. Več informacij najdete na spletni strani [www.timago.com](http://www.timago.com). Hvala, ker ste izbrali Timago!

# BRUKSANVISNING

## Duschpall utan ryggstöd – TF-system

Produktkod: TGR-R KP 340L



### 1. Utförande


Duschpallen består av en aluminiumram och en bred sits av slitstark PVC. Den har höj- och sänkbara fötter med halkskydd i gummi och sidohandtag vid sitsen för enkel användning. Speciellt utformade gummifötter förhindrar effektivt att de glider på våta ytor. Pallen är dessutom utrustad med TF-systemet för enkel montering.

### Delar:

- a. sits
- b. basrör
- c. höjdjustering – låsstift
- d. halkskydd

### Satsen innehåller:

- sits – 1 st.
- pallbas – 2 st.
- fötter med höjdjustering – 4 st.
- monteringskruvar (vingskruvar) – 5 st.

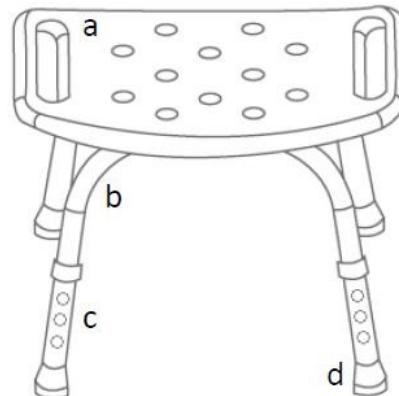

### 2. Avsedd användning

En duschkall är ett hjälpmittel som gör det lättare för användaren att utföra hygieniska uppgifter. Den rekommenderas för personer med nedsatt rörlighet som gör det omöjligt eller svårt att självständigt utföra aktiviteter i det dagliga livet. Pallen rekommenderas för användning i duschar, badkar, badrum och andra våtutrymmen i hemmet och på sjukhus.

### 3. Montering

**Steg 1.** Lägg pallens sits platt på marken.

**Steg 2.** Använd sedan fem vingskruvar med brickor för att sätta ihop sitsen med

de korsade rören i pallbasen.

**Steg 3.** Rören för pallbasen ska anslutas till fötterna.

## HÖJDJUSTERING

- För att justera höjden på pallen ska man trycka in metallstiftet, välja önskad höjd av foten och låsa positionen med metallstiftet i förhållande till varandra. Fötterna är justerbara i steg om 2,5 cm.

**Obs!** Stiften i alla fötter måste sättas på samma nivå.

## 4. Tekniska specifikationer

Bredd	49 cm
Djup	39 cm
Höjd	36-46 cm
Sitsens mått	49 x 29 cm
Vikt	2,06 kg
Max belastning	136 kg

## 5. Anmärkningar och anvisningar

**Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av pallen, bristande efterlevnad av säkerhetsreglerna och för icke avsedd användning.**

## 6. Underhåll

- Pallen ska rengöras regelbundet med vatten, en svamp och milda rengöringsmedel för plast, t.ex. tvål eller milda rengöringsmedel som godkänts av PZH, och torkas torrt efter varje användning.
- **Använd inte** något av följande för rengöring: starka rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller andra lösningsmedel (risk för skador på ramen, synliga defekter och följacktlig förlust av garantirättigheter).

### **• Man ska systematiskt kontrollera:**

- vingskruvarnas åtdragning
- lässtiftens skick
- rörens skick (för sprickor)

Det rekommenderas att gummikappan inspekteras regelbundet. Om den är sliten, byt ut kappan mot ett ny.

## 7. Garantiuppgifter

Alla produkter som vårt företag distribuerar omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som du fick vid köpet. Samtidigt vill vi påpeka att inköpsbeviset (kvitto eller faktura) ska bevaras för att kunna åberopa garantin.

## 8. Märkningar

<b>REF</b>	Referensnummer		Tillverkare
<b>LOT</b>	Partinummer		Tillverkningsdatum
<b>SN</b>	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs		Läs bruksanvisningen
<b>CE</b>	Tillverkaren har bedömt överensstämmelse med de väsentliga kraven som gäller för medicintekniska produkter.		

Hela vårt sortiment hittar du hos våra återförsäljare. Läs mer på [www.timago.com](http://www.timago.com). Tack för att du valt Timago!



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Poland

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



03/2024(I)