

Consultórios

LINHA PRESTIGE

BRAÇO DA CADEIRA REBATÍVEL PNEUMÁTICO

PEDAL JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

SISTEMA FLUSH

UNIDADE DE ÁGUA COM SENSOR
DE PROXIMIDADE E PORTA COPO

REFLETOR 5 LEDS COM SENSOR
DE PROXIMIDADE

SISTEMA ANTIESMAGAMENTO



CADEIRA

- Sistema antiesmagamento.
- Braço de apoio para o paciente com acionamento pneumático.
- Encosto de cabeça anatômico e biarticulado.
- Pedal joystick com posição volta a zero; 3 posições de trabalho; posição de cuspir e acionamento do refletor.
- Posição de Trendelenburg.

EQUIPO

- Braço com trava pneumática
- Até 5 terminais no equipo, de acordo com a versão
- Bandeja dupla (Prestige 3)
- Controle PAD com negatoscópio: acionando todos os comandos da cadeira, equipo, unidade de água e refletor

UNIDADE DE ÁGUA

- Braço Alcance com PAD
- Fácil acesso aos filtros de detritos.
- Unidade de água rebatível em 60°.
- Acionamento elétrico da água da cuba e do porta copo.
- Terminal Sugador BV e Vac Plus.
- Sensor de Proximidade.
- Porta Copo.

REFLETOR 5LEDS

- Menor consumo de energia e maior durabilidade.
- Sensor de proximidade.
- Seleção da intensidade luminosa, de 25.000, 35.000 e 45.000 LUX.
- Puxadores: Removíveis e autoclaváveis.
- Protetor Frontal: Removível.

ITENS DE SÉRIE

Refletor Sirius 5 LEDs

- Tecnologia de iluminação LED: eficiente em termos energéticos e duradouro.
- Sensor de proximidade para ativação e luz controle de intensidade.
- Fonte de luz fria, sem geração de calor.
- Spot retangular para uma maior área de trabalho.
- Design inovador com manuseio ergonômico.
- Alças laterais e autoclaváveis.
- Protetor frontal removível para proteção do sistema óptico.

- Sensor 5LEDs
- Sistema óptico com 5 LEDs
- Três intensidades: 25.000, 35.000 e 45.000 LUX



Braço alcance com PAD



Micromotor Elettrico

- Transmissão de Velocidade: 1:1
- Velocidade Máxima: 40.000 rpm
- Torque Máximo: 3.5 N.cm
- Sistema de Irrigação: Interno
- Sistema de Iluminação: LED+
- Tipo de Conexão: ISO 3964 Acoplamento Curto (INTRA)
- Peso: 57 gramas

(somente na versão Prestige 3)



Controle PAD com negatoscópio

- Subida e descida do assento da cadeira
- Subida e descida do encosto da cadeira
- Bloqueio de movimentos
- Posição de volta à zero
- Acionamento da água da cuba e do porta-copo
- Posição de cuspir e retorno à última posição
- Programação de trabalho
- Acendimento do refletor



COMPARE AS VERSÕES

	PRESTIGE 1	PRESTIGE 3
Cadeira	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível	Encosto de cabeça biarticulado Braço rebatível
Equipo	Air	Air
Acessórios Equipo	Tampo de inox Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro	Bandeja Dupla Controle PAD Negatoscópio Sistema Flush Manômetro
Terminais Equipo	Seringa Trílice 2 Terminais de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação	Seringa Trílice 1 Terminal de Alta Rotação 1 Terminal de Baixa Rotação Ultrassom Jato de Bicarbonato Micromotor Elétrico
Acessórios Unidade de Água	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master	Bacia removível em porcelana Braço Alcance com PAD Porta Copo Sensor de Proximidade Válvula Seletora Válvula Master
Terminais Unidade de Água	Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Trílice	Sugador Vac Plus Sugador BV Seringa Trílice
Refletor	Sirius 5 LED's	Sirius 5 LED's


CORES DABI

Estofamentos que inspiram a sua rotina de trabalho

COURO



PVC

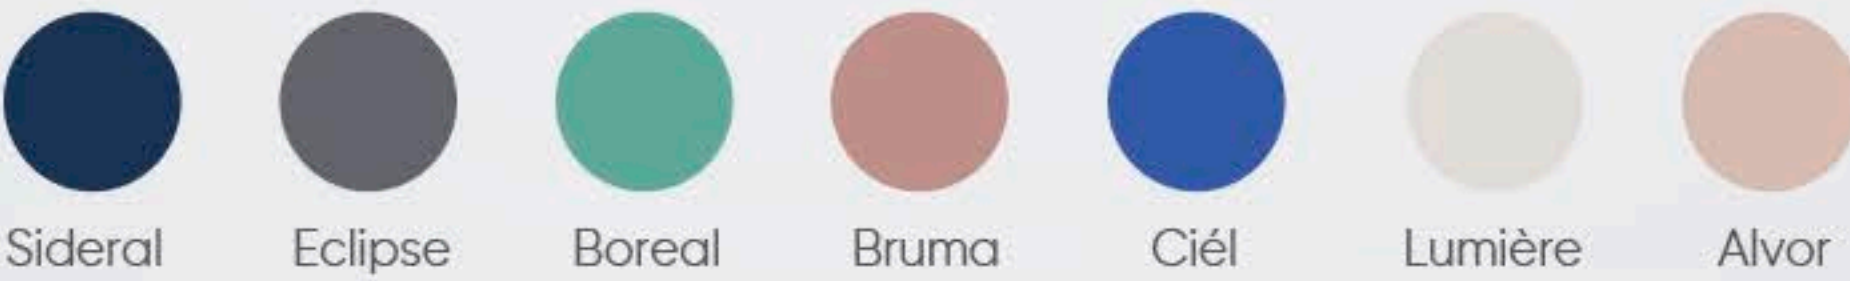

SOLICITE ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. As cores podem ter sofrido alterações na reprodução gráfica. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. CONFIGURAÇÃO CADEIRA NEW CROMA: ANVISA 10069210062. UNIDADE DE ÁGUA SYNCRUS G3: ANVISA 10069210063. EQUIPO SYNCRUS G3 E SYNCRUS G3 H: ANVISA 10069210075. REFLETOR Persus L; Persus LED; Sirius G8 Sensor 3 Leds; Sirius G8 Sensor 5 Leds; Sirius G8 Sensor 5 (3X2) Leds: ANVISA 10069210069.

51000000170: Versão - Dez/2025.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante



dabiatlante_oficial

