


สรุปคำถามและคำตอบ (Questions and Answers Summary)
การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม

(Procurement of Equipment for Satellite Assembly, Integration and Testing Facility)

1. คำถาม (Question 1) ในแบบที่ได้รับ ยังไม่มีผังแสดงแผนการวางเครื่องมือ (There is no equipment installation plan provided in the TOR.)

คำตอบ (Answer 1) เอกสารข้อกำหนดได้ระบุผังการวางเครื่องมือไว้เฉพาะส่วนที่เป็นเครื่องมือขนาดใหญ่ เช่น อุปกรณ์ Vibration test Thermal Vacuum Chamber Mass Properties Measurement และ Foundation Isolator รายละเอียดดังปรากฏข้างล่างนี้ (The equipment installation plan for large-size equipment such as Vibration Test, Thermal Vacuum Chamber, Mass Properties Measurement and Foundation Isolator has already been provided in TOR, see below for further information.)

Layout AIT building 1st fl.

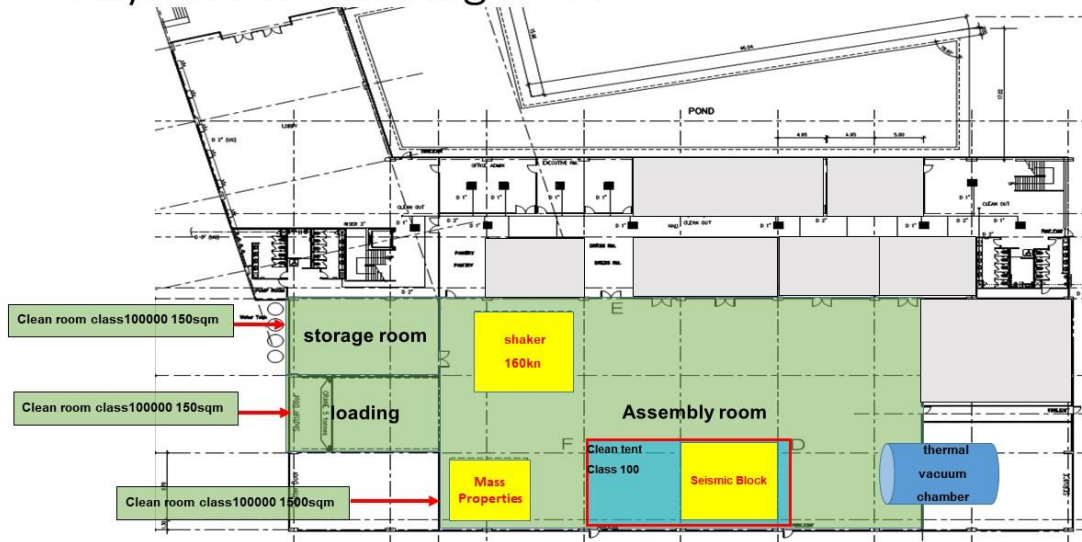

ภาพ Equipment Installation plan

2. คำถาม (Question 2) เครื่องทดสอบและเครื่องมือต่าง ๆ ถ้าเป็นกรณีนำเข้าจากต่างประเทศ ใครเป็นผู้รับผิดชอบกับภาษีศุลกากร (Who will be responsible for the customs duty in case the import is required?)


คำตอบ (Answer 2) ผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี อากร และค่าธรรมเนียม ทั้งหมด โดยราคาที่เสนอ ต้องรวมภาษี อากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้แล้ว (The Contractors shall be responsible for all taxes, customs duty, levies and fees. The bid price shall include all tax, levies, fees.)

3. คำถาม (Question 3) ห้อง Clean room จัดวางที่ไหน อย่างไร (Where is the Clean room?)

คำตอบ (Answer 3) ตำแหน่งห้อง Clean room แสดงอยู่ในเอกสารข้อกำหนดภาพที่ 4 หน้า 26 หรือ คำตอบในข้อ 1 (The Clean room location is shown in Figure 4, Page 26 of the TOR (Page 32 of the English-version TOR) and is also shown in the Answer 1).

4. คำถาม (Question 4) ในแบบไม่ได้แสดงถึงภาพตัด เพื่อระบุความสูง และ section ต่าง ๆ ของห้อง clean room (The TOR does not provide cross section diagram of the Clean room which is needed to get the height and cross-sectional information.)

คำตอบ (Answer 4) เอกสารข้อกำหนดไม่ได้ระบุรายละเอียดภาพตัดขวางของ Clean room ไว้ แต่ได้ ระบุข้อมูลความสูงของห้อง Clean room ไว้ในภาคผนวก ข. ข้อ 1.1 (The TOR does not provide cross section diagram of the Clean room, nonetheless, the height of the Clean room is provided in Appendix B, 1.1.) ทั้งนี้ ภาพตัดขวางของ Clean room แสดงดังรายละเอียดข้างล่าง (The cross section diagram of the Clean room is provided below for further information).

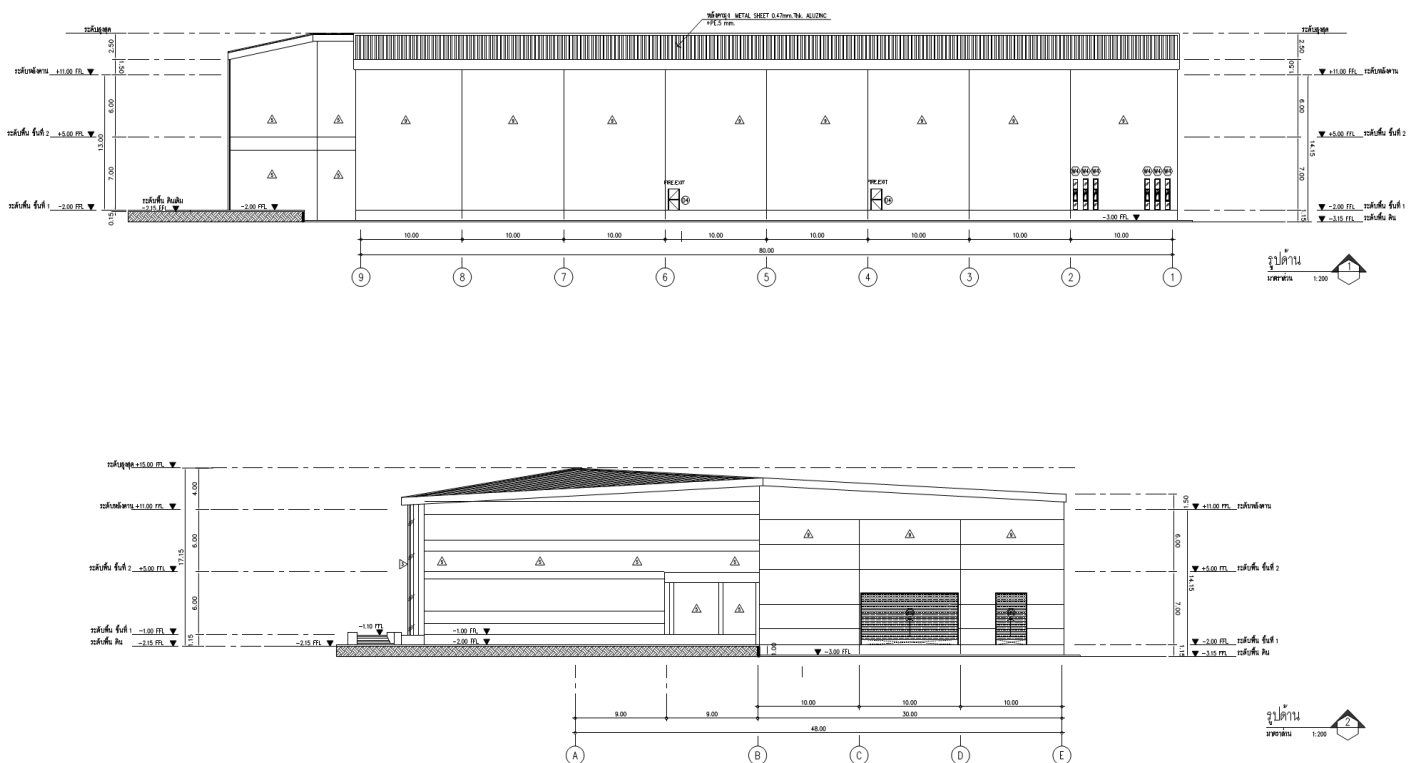

ภาพที่ 2 ภาพตัดขวางอาคาร ห้อง Clean Room