


『外科病理学』
(第5版第1刷)

正誤表


本書におきまして、下記の通り記載内容に誤りがございました。訂正してお詫びいたします。

●p.456 図11-22 Updated Sydney Systemのvisual analoguevisual analogue

(誤)

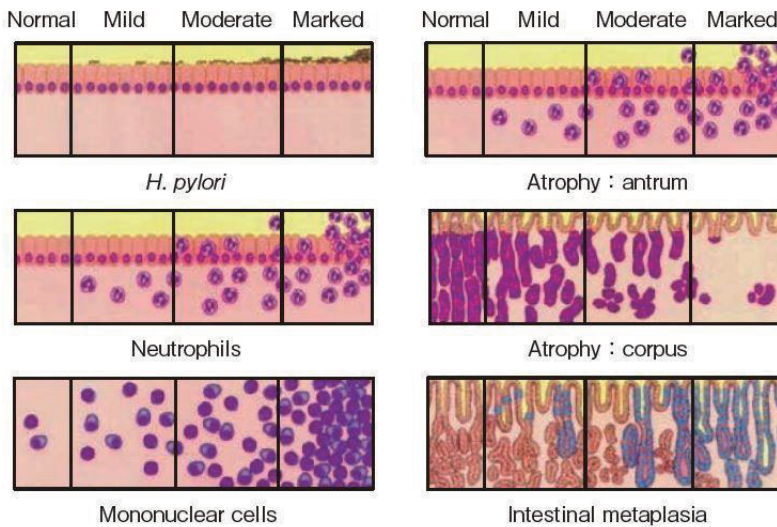

(正)

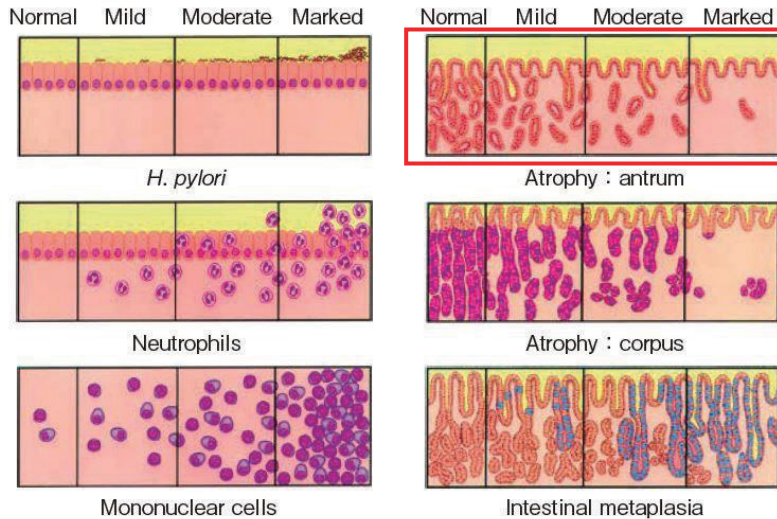

●p.1736 図42-1 角膜の組織像

(誤)

(正)

