

BEAM シリーズ 6 巻 『輸液のコツとポイント』

(第1版第1刷～第2刷)
正誤表

本書におきまして、下記のとおり記載内容に誤りがありました。
訂正してお詫びいたします。

- p13 図 6, p15 図 8, p16 図 9, p18 図 10, p31 図 1 の各図において Na^+ の値を訂正。

1) 細胞内液中の Na^+ の値

誤 Na^+ 140 mEq/L

↓


正 Na^+ 15 mEq/L

2) 細胞外液中の Na^+ の値

誤 Na^+ 14 mEq/L

↓

正 Na^+ 140 mEq/L

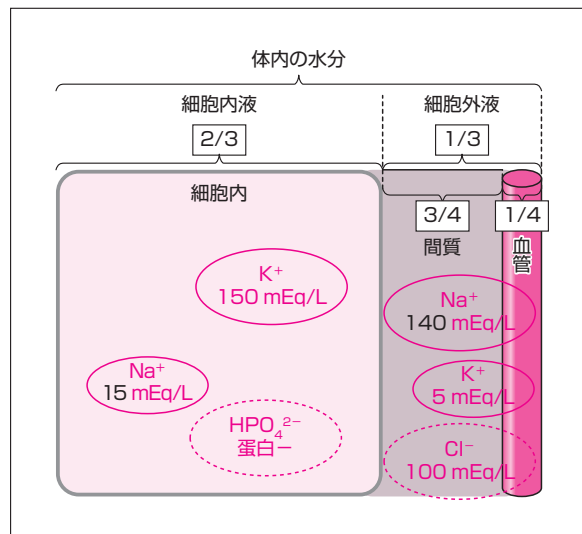

- p45 中段の「point」

誤	・血漿 $[\text{Na}] >$ 尿 $[\text{Na}] +$ 尿 $[\text{K}]$	⇒	低 Na 血症は進行性
	・血漿 $[\text{Na}] <$ 尿 $[\text{Na}] +$ 尿 $[\text{K}]$	⇒	低 Na 血症は改善傾向
	↓		
正	・血漿 $[\text{Na}] <$ 尿 $[\text{Na}] +$ 尿 $[\text{K}]$	⇒	低 Na 血症は進行性
	・血漿 $[\text{Na}] >$ 尿 $[\text{Na}] +$ 尿 $[\text{K}]$	⇒	低 Na 血症は改善傾向